FutureMed
Ul. Ostrowiecka 7A, Sienno
+48 22 228 20 13

APLIKATOR WIELOIGŁOWY DR NIKOLAYA LYAPKO, MATA 7.0 AG

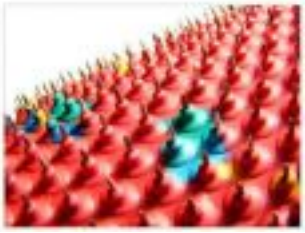

cena: 390,00 PLN

Opis słownikowy

Postać	aplikator
Producent	aplimedica s.c.
Wysyłka	1-3 dni

Opis produktu

APLIKATOR WIELOIGŁOWY DR NIKOLAYA LYAPKO, „MATA" 7.0 AG jest to największa mata rahabilitacyjna, w przypadkach profilaktyki i w kompleksowej terapii chorób i uszkodzeń aparatu ruchowego takich jak na przykład:
- objawy rwy kulszowej, barkowej, udowej
- dyskopatie
- wypukliny i przepukliny krążka międzykręgowego
- zmiany zwyrodnieniowe
- stany pourazowe
- mięśniobóle
- skrzywienia kręgosłupa

Rozstaw igieł 7,0 mm, wymiary 27,5 cm x 48,0 cm.

Przy dyskomforcie odczuwalnym w przeciągu 10-15 minut, aplikator należy stosować ponownie tylko po upływie 5-10 godzin lub dopiero w dniu następnym. Przyczynami odczuć dyskomfortu mogą być: nieprawidłowe ułożenie maty leczniczej, tzn. nierównomierność obciążenia na igły.

W celu usunięcia odczuć dyskomfortu należy unieść się nad aplikatorem i położyć się na nim ponownie, podkładając wcześniej pod stawy kolanowe miękki wałek.

Czas oddziaływania na skórę aplikatora, ma ścisły związek z otrzymaniem pożądanego efektu:
- w celu tonizowania, znieczulenia przy ostrych bólach, dla podwyższenia wydolności i ciśnienia tętniczego przy hipotonii – ok. 7-10 minut;
- w celu osłabienia, bądź nawet usunięcia długotrwałych chronicznych bólów, obniżenia ciśnienia tętniczego, efektu relaksacyjnego i usypiającego – ok. 15-30 minut i dłużej.

Czas terapii leczniczej – 1-2 tygodnie. Można ją powtórzyć po upływie 10-14 dni. W praktyce stosując codziennie aplikator w przeciągu

FutureMed
Ul. Ostrowiecka 7A, Sienno
+48 22 228 20 13

kilku miesięcy, można liczyć na trwała poprawę samopoczucia, usunięcia chronicznych bólów, obniżenie wagi, podwyższenie życiowego wigoru i wydolności organizmu.

UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJA

W warunkach domowych — zaleca się obróbkę roztworem myjącym, przemywanie pod bieżącą wodą i suszenie strumieniem gorącego powietrza (suszarką).

W placówkach leczniczych do sterylizacji aplikatorów używa się powszechnie stosowanych preparatów medycznych do dezynfekcji powierzchni sprzętu.

Przy poprawnym korzystaniu aplikatora jego termin przydatności stanowi 5-7 lat.

SKŁAD:

- żelazo
- miedź
- nikiel
- cynk
- srebro
- podstawa: guma medyczna